

FIG. 1

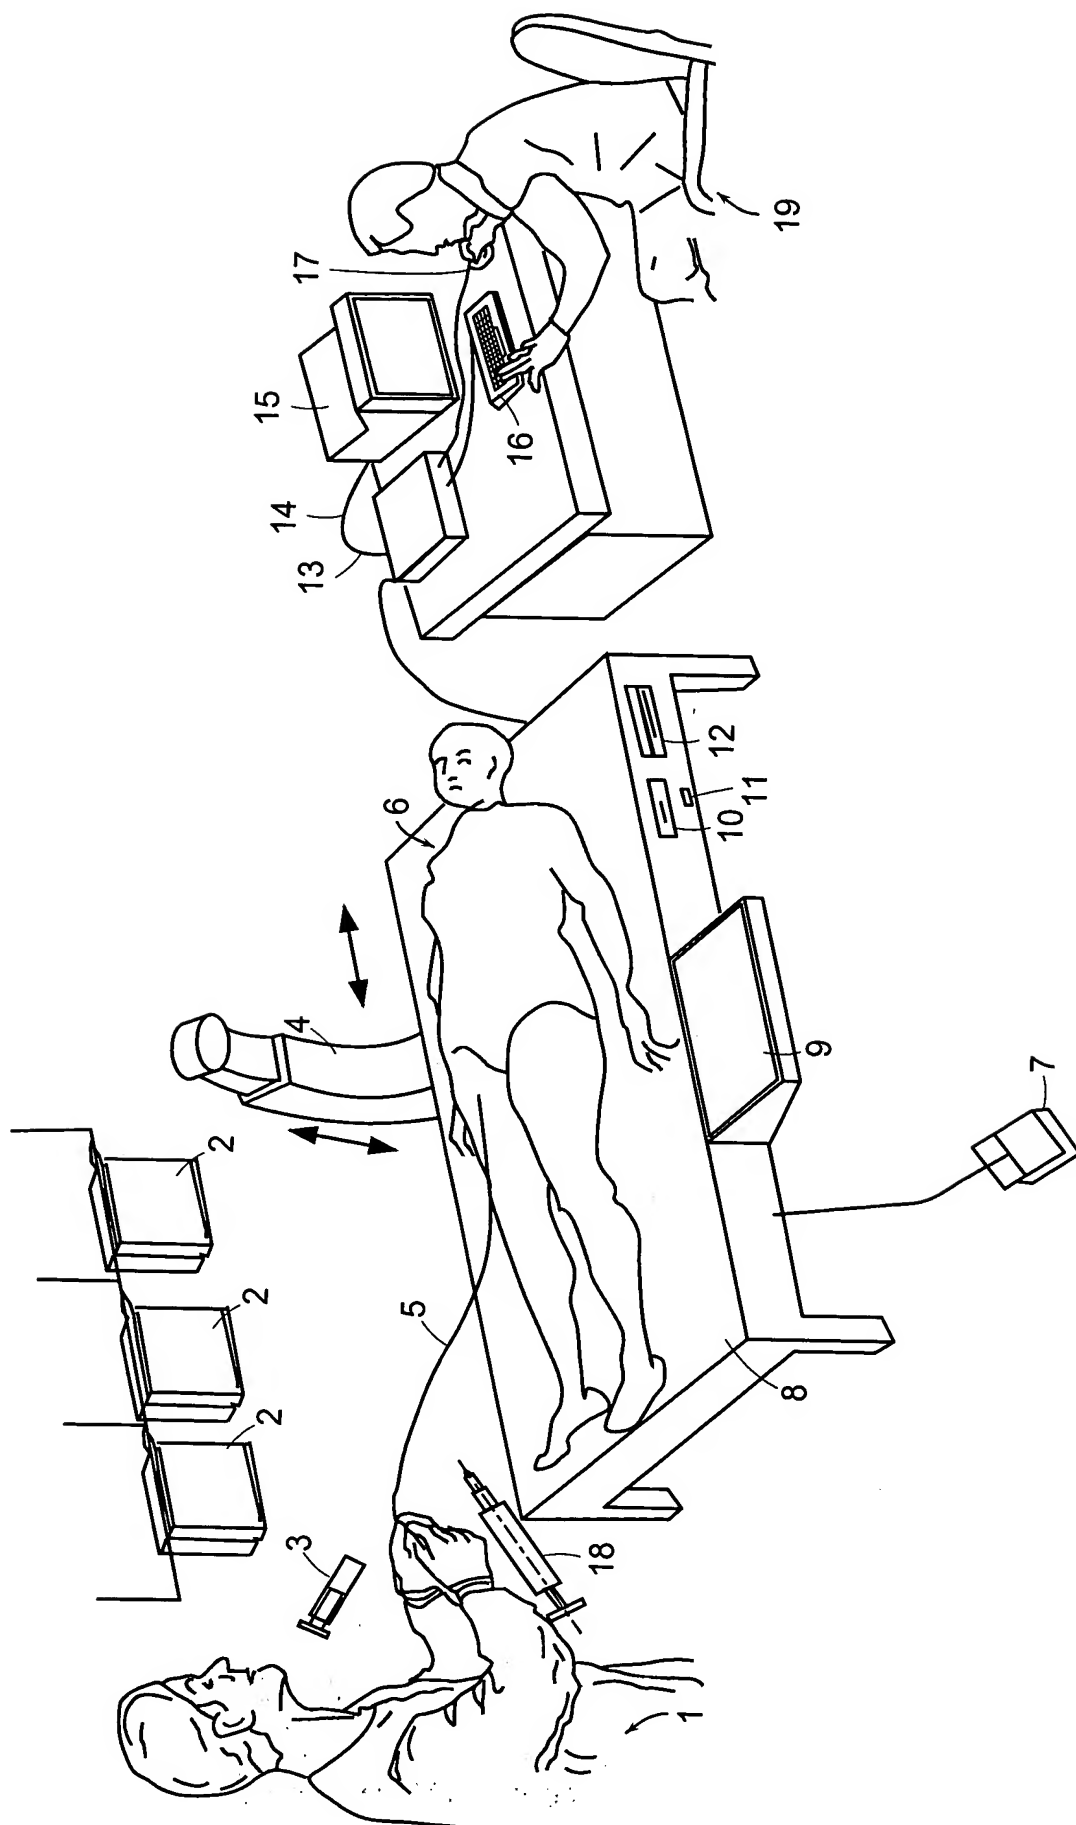
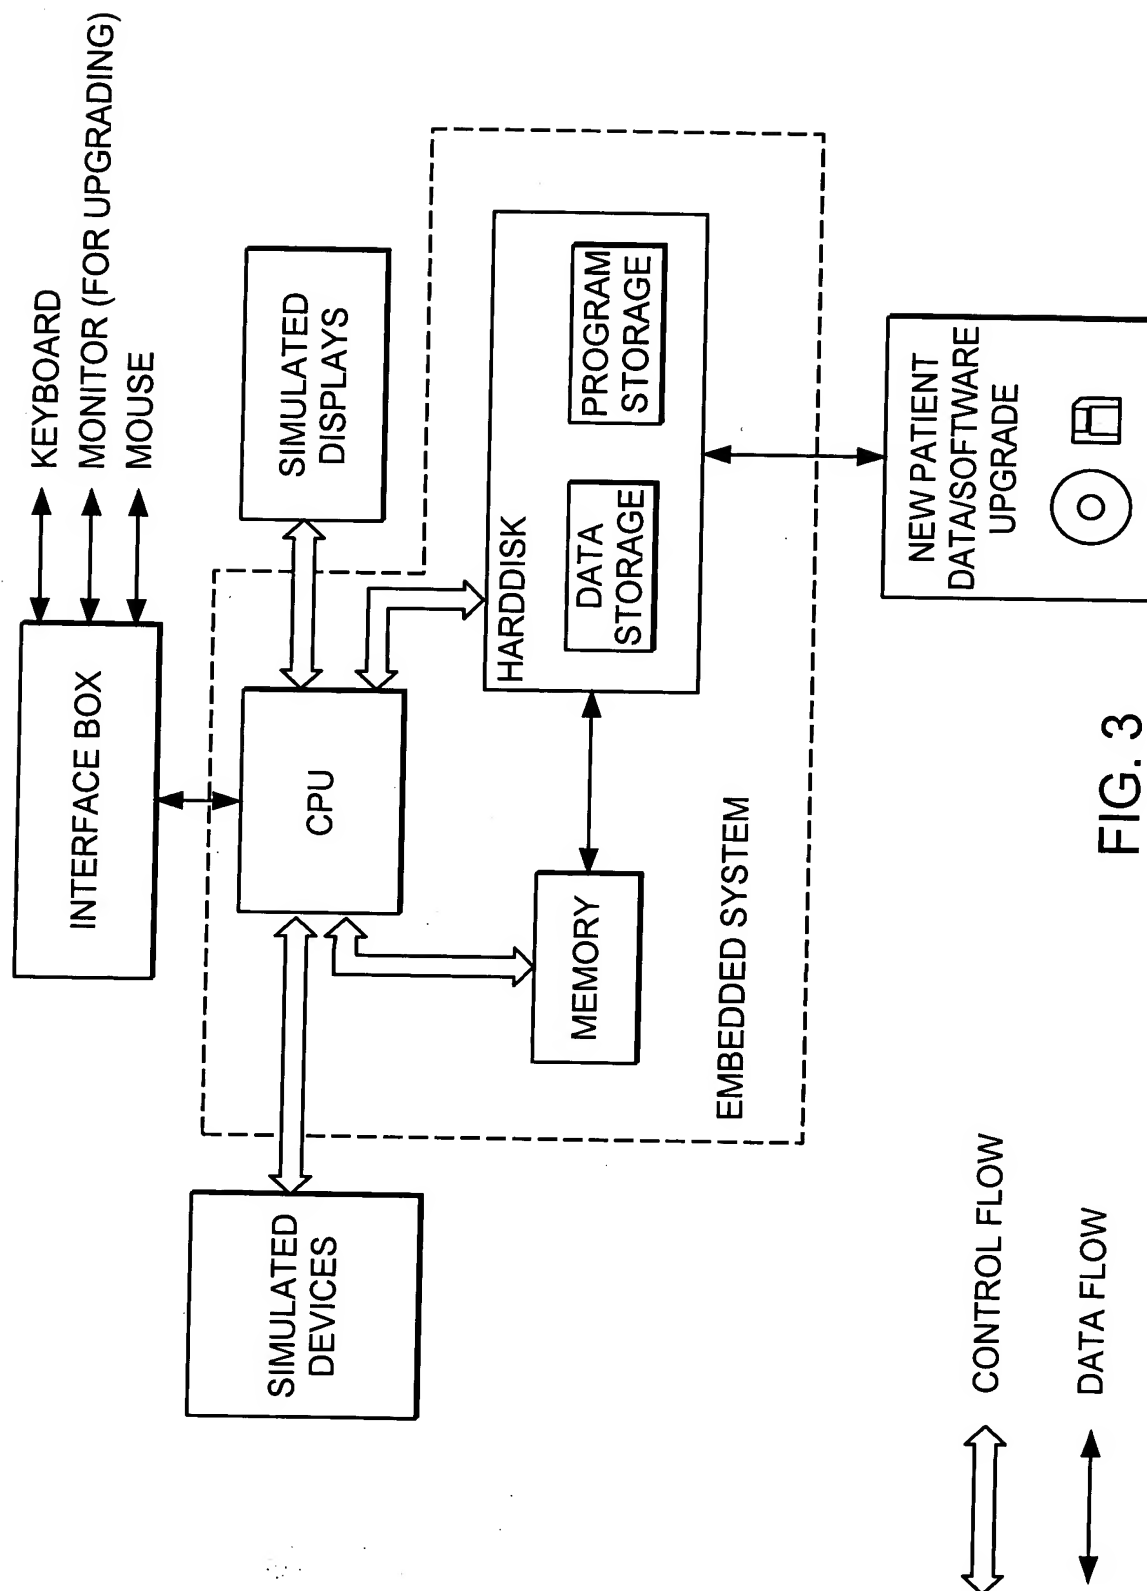


FIG. 2



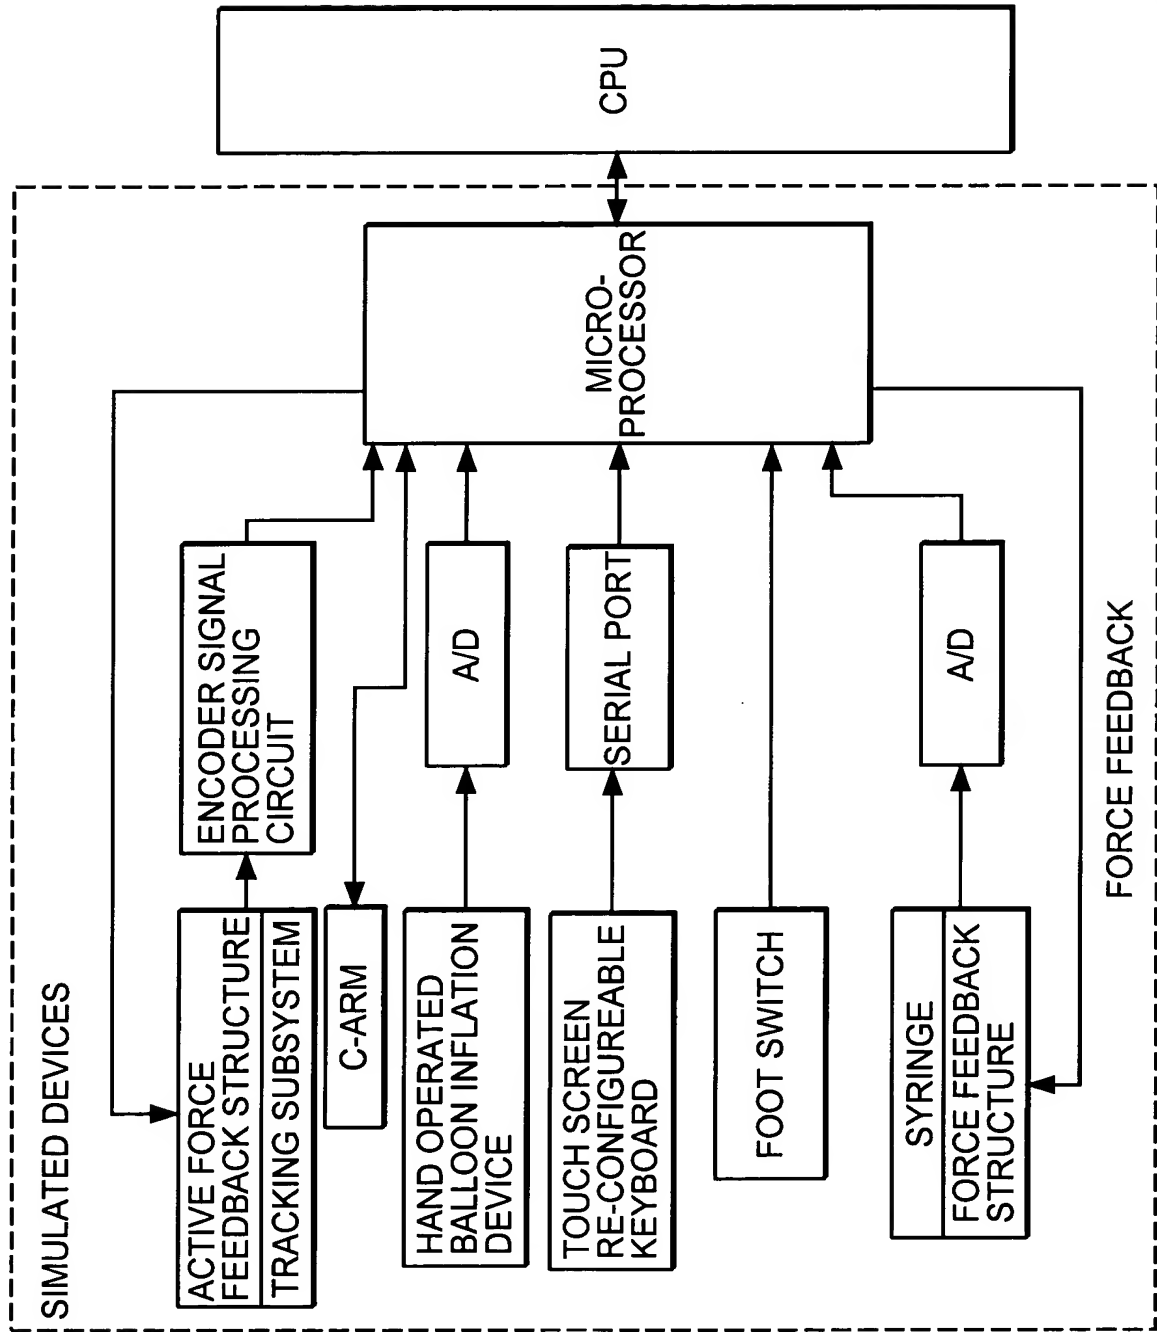


FIG. 4

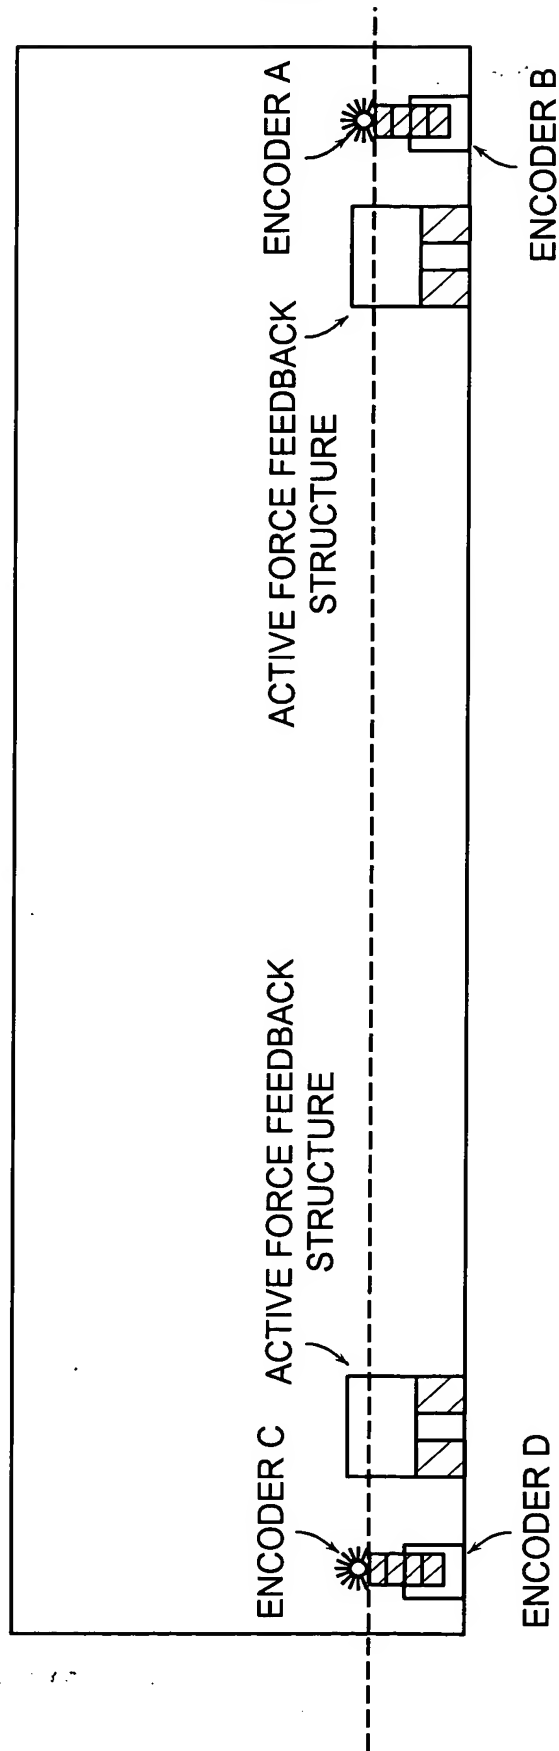


FIG. 5A

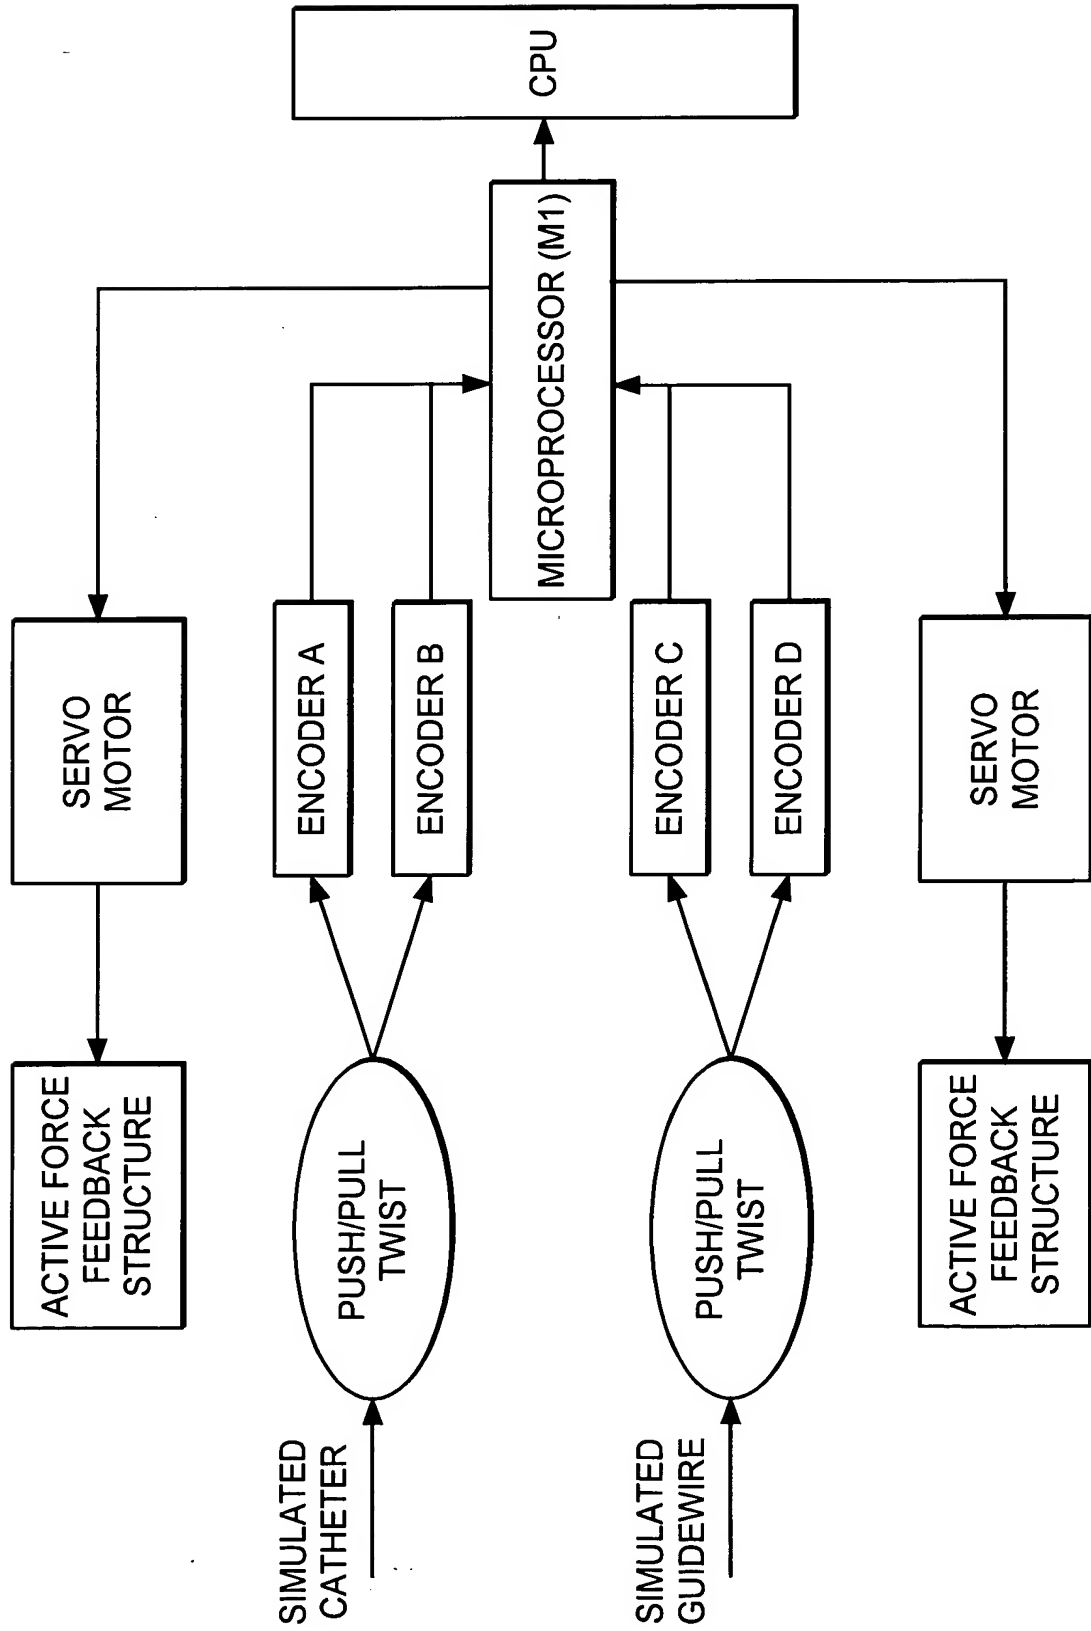


FIG. 5B

TRACKING UNIT ASSEMBLY

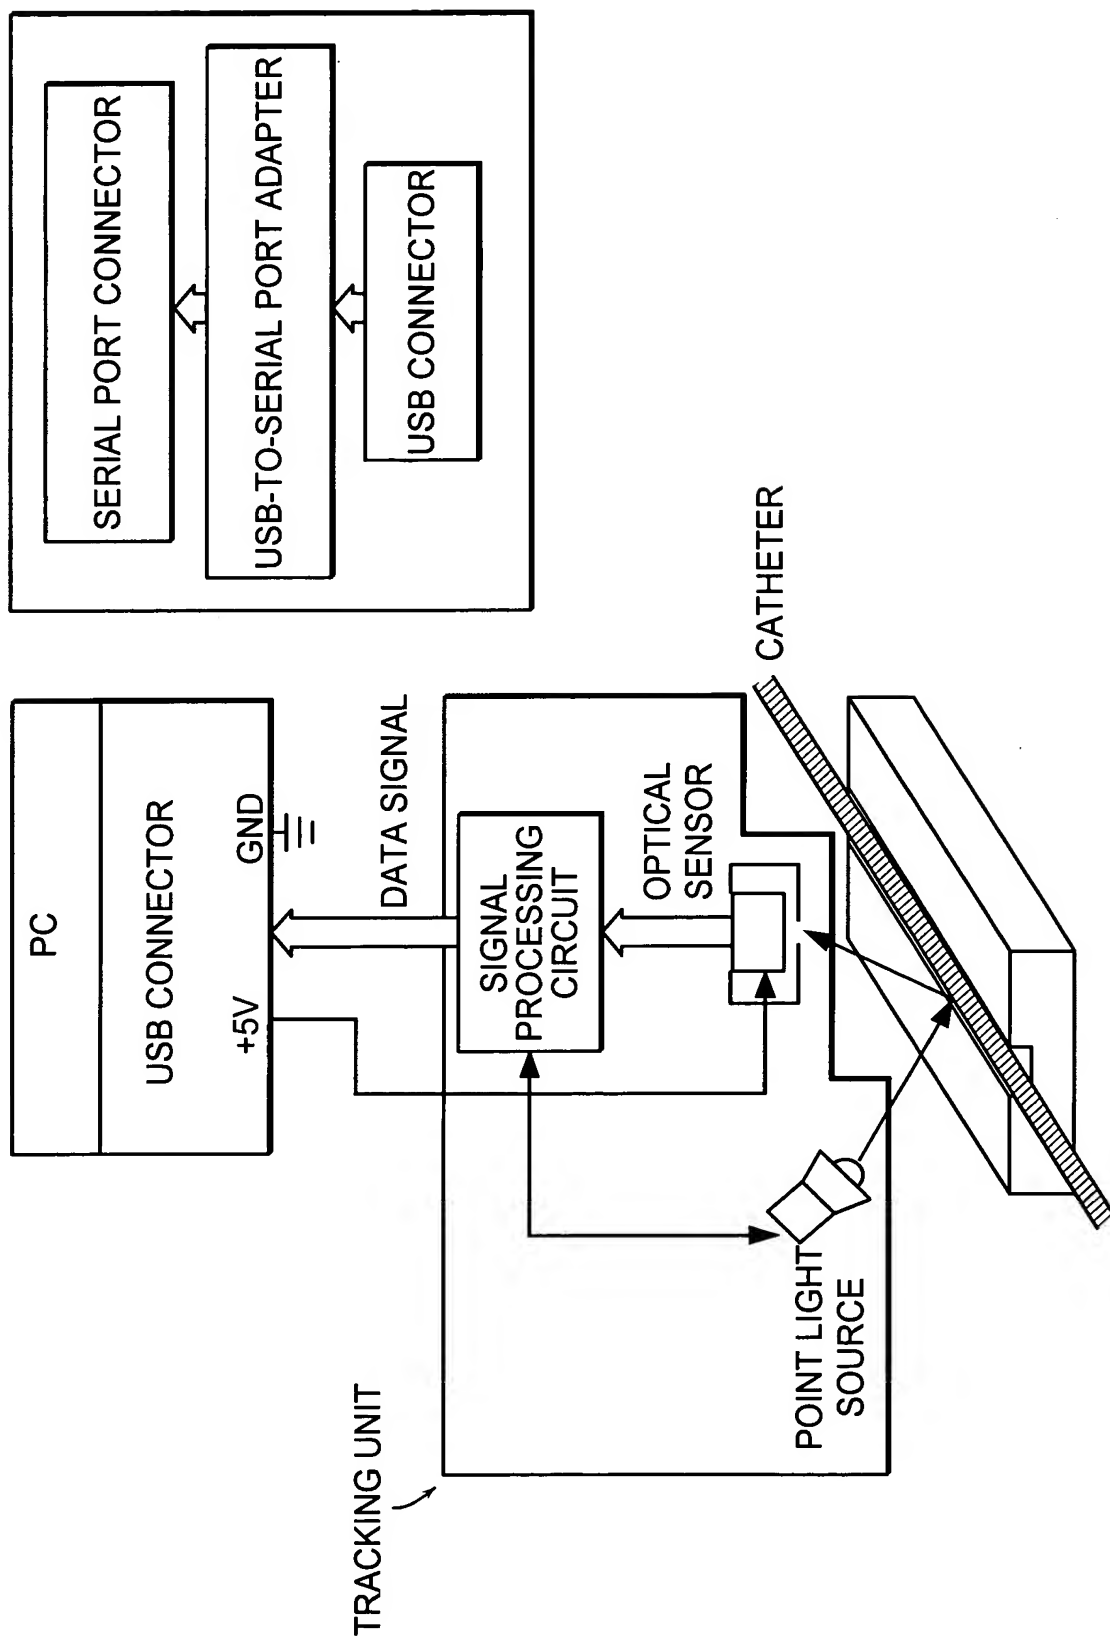


FIG. 6A

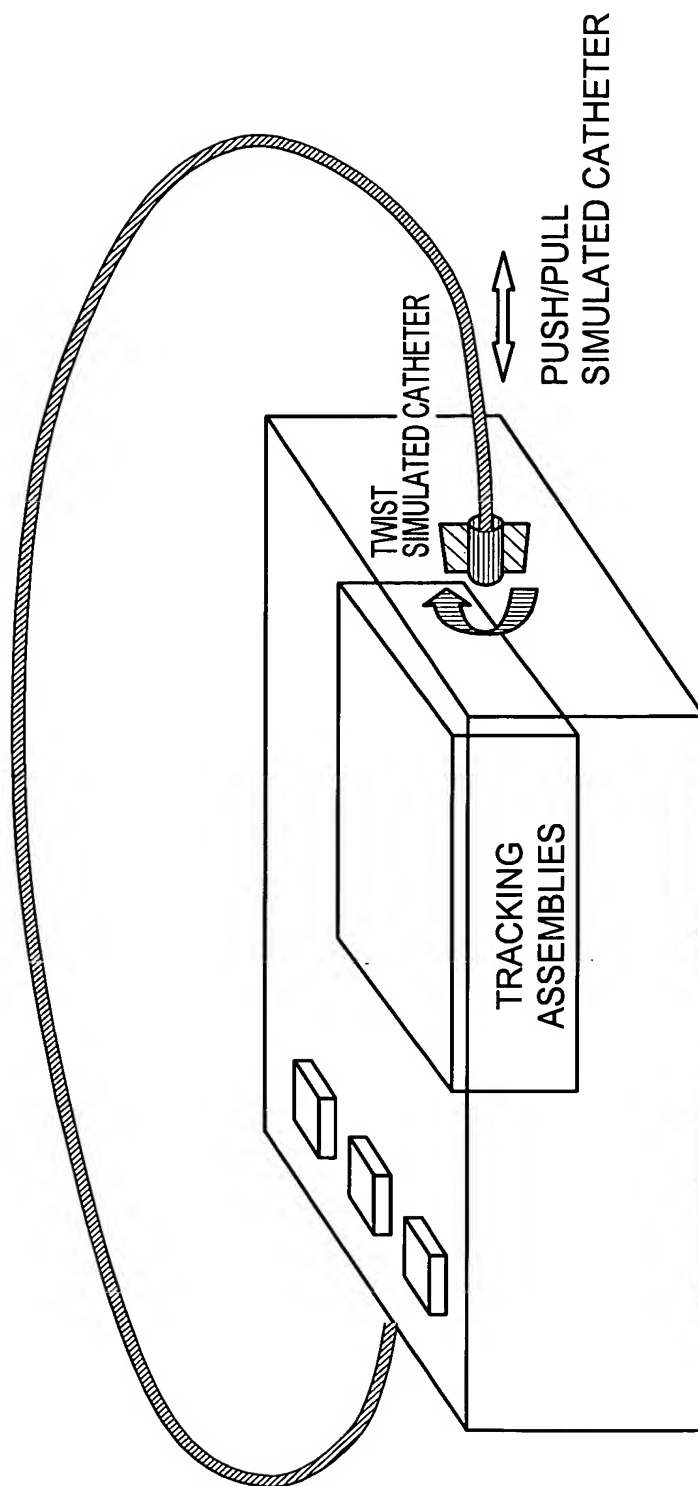


FIG. 6B

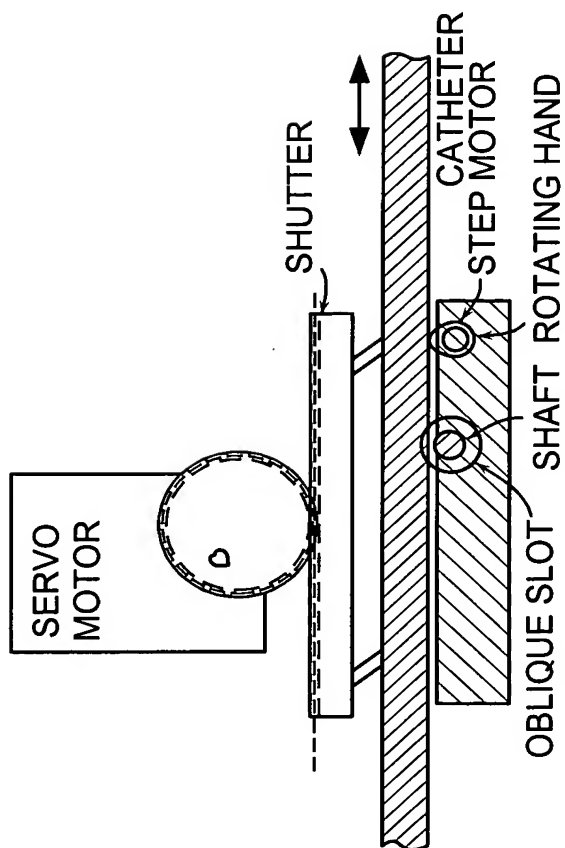


FIG. 7A

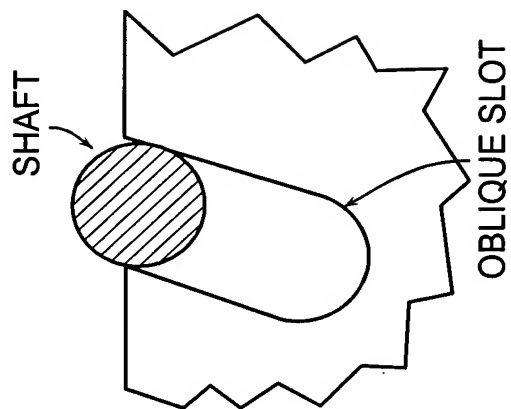


FIG. 7B

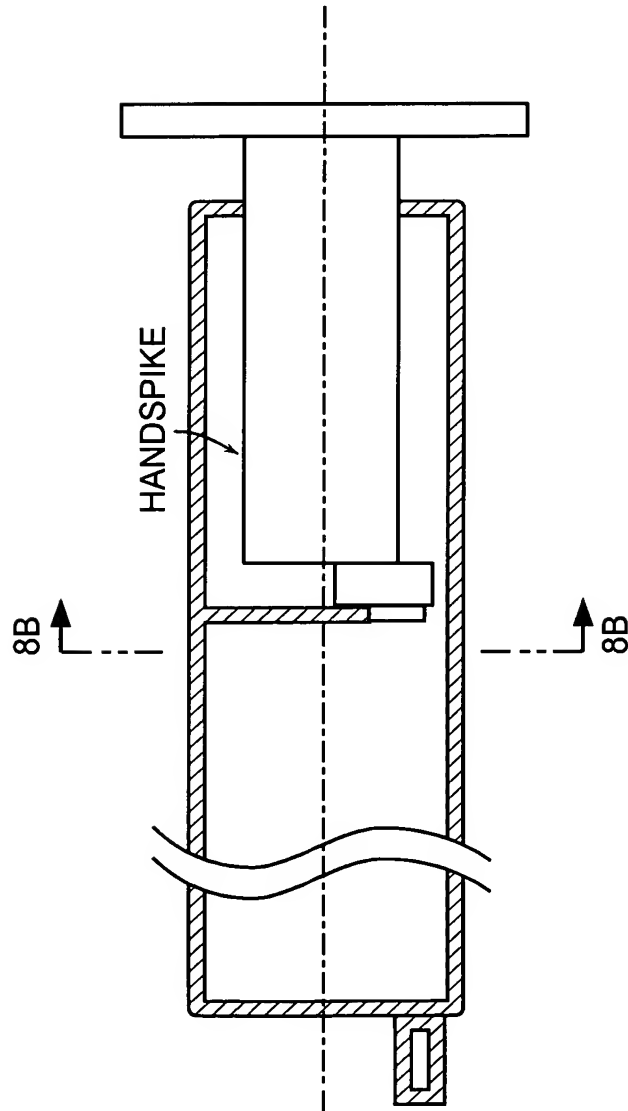


FIG. 8A

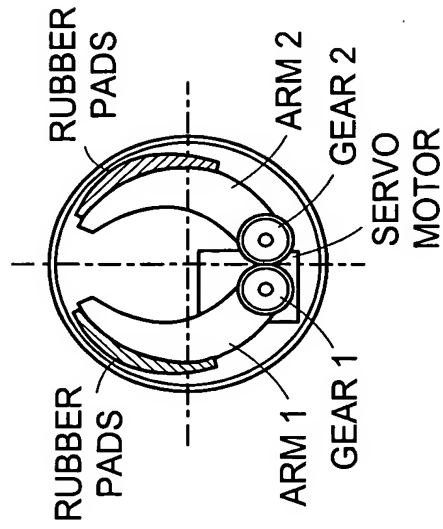


FIG. 8B

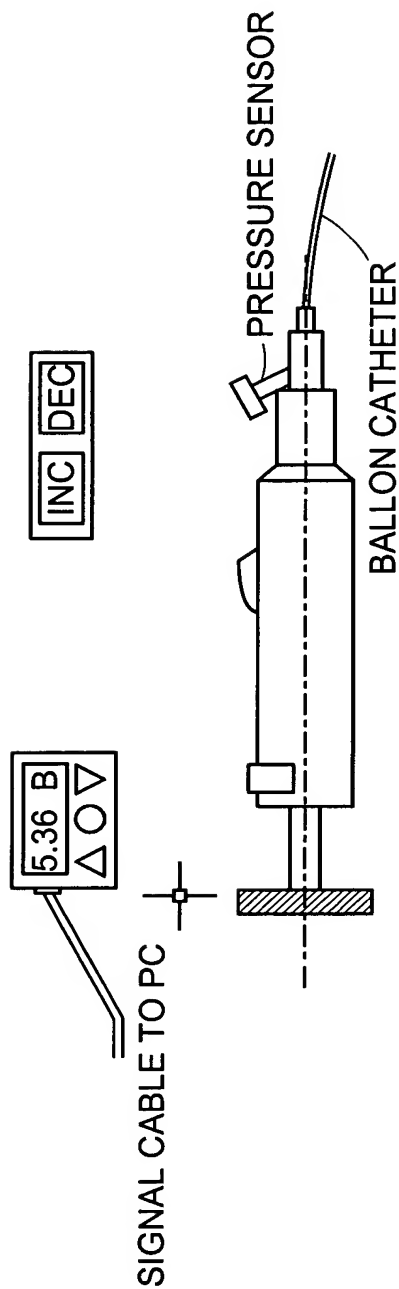


FIG. 9

12/20

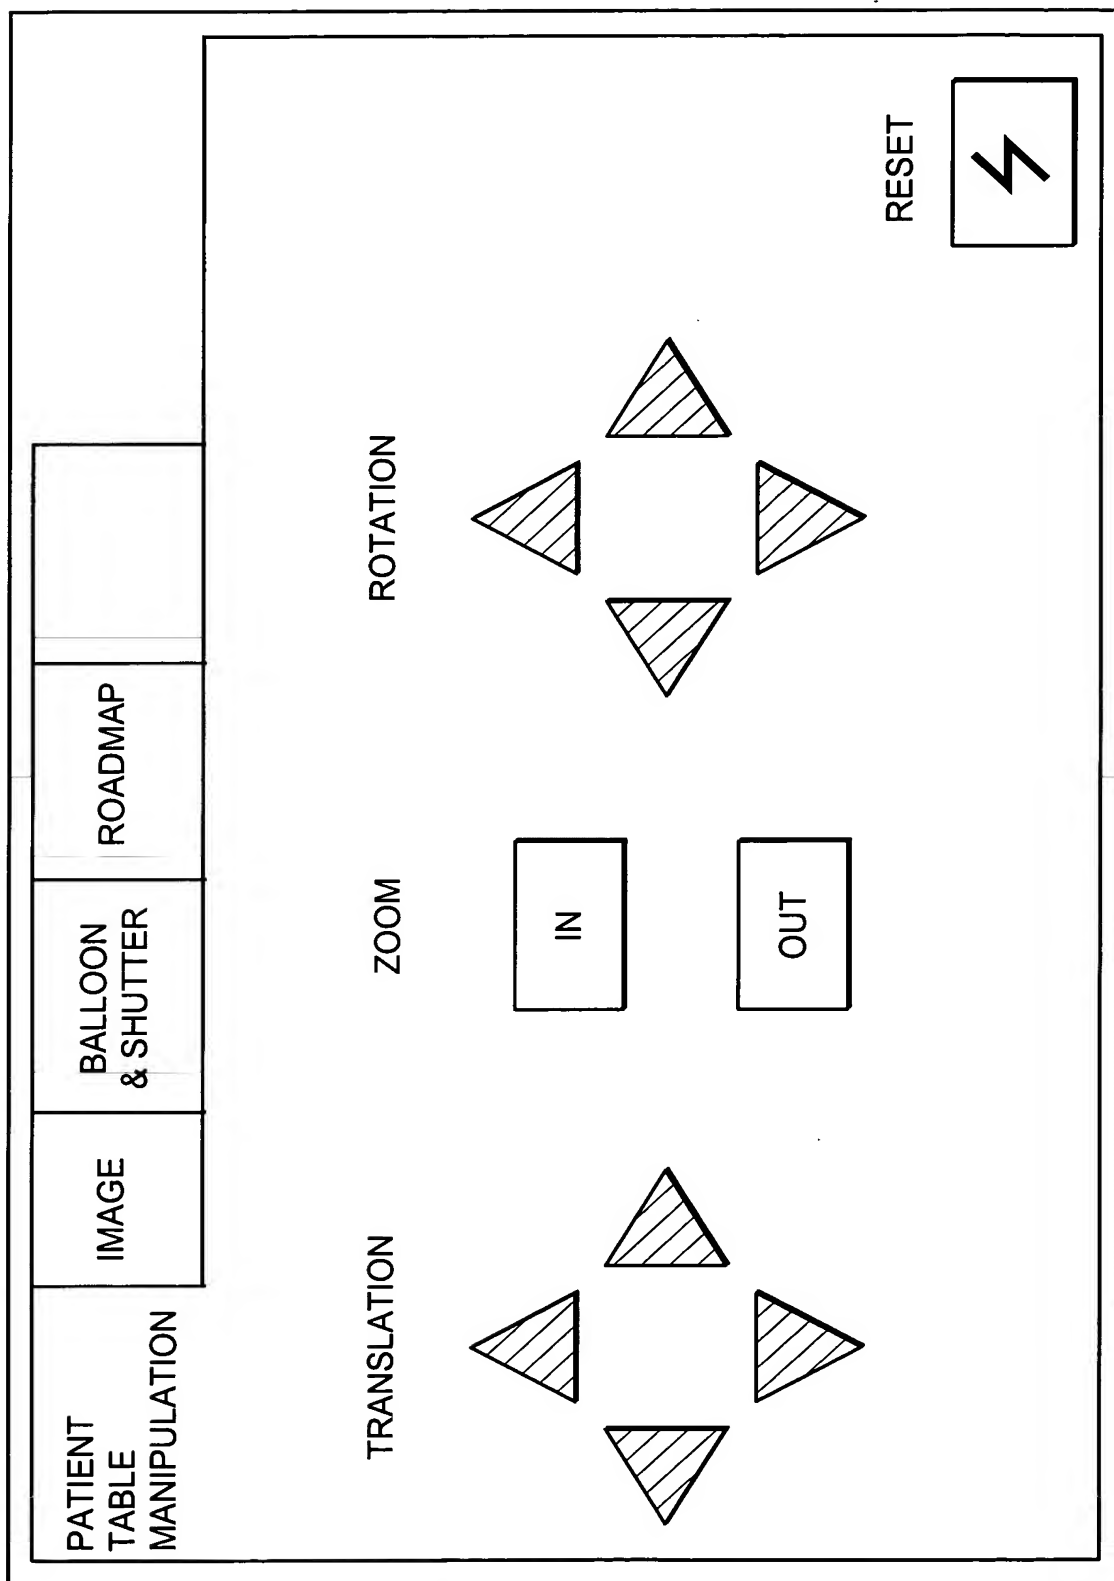


FIG. 10A

PATIENT TABLE MANIPULATION	IMAGE	BALLOON & SHUTTER	ROADMAP	
<div>BRIGHTNESS</div> <div><div><div>+</div><div>-</div></div></div> <div>CONTRAST</div> <div><div><div>+</div><div>-</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>INVERT COLOR</div></div> <div>RESET</div> <div><div>⚡</div></div>				

FIG. 10B

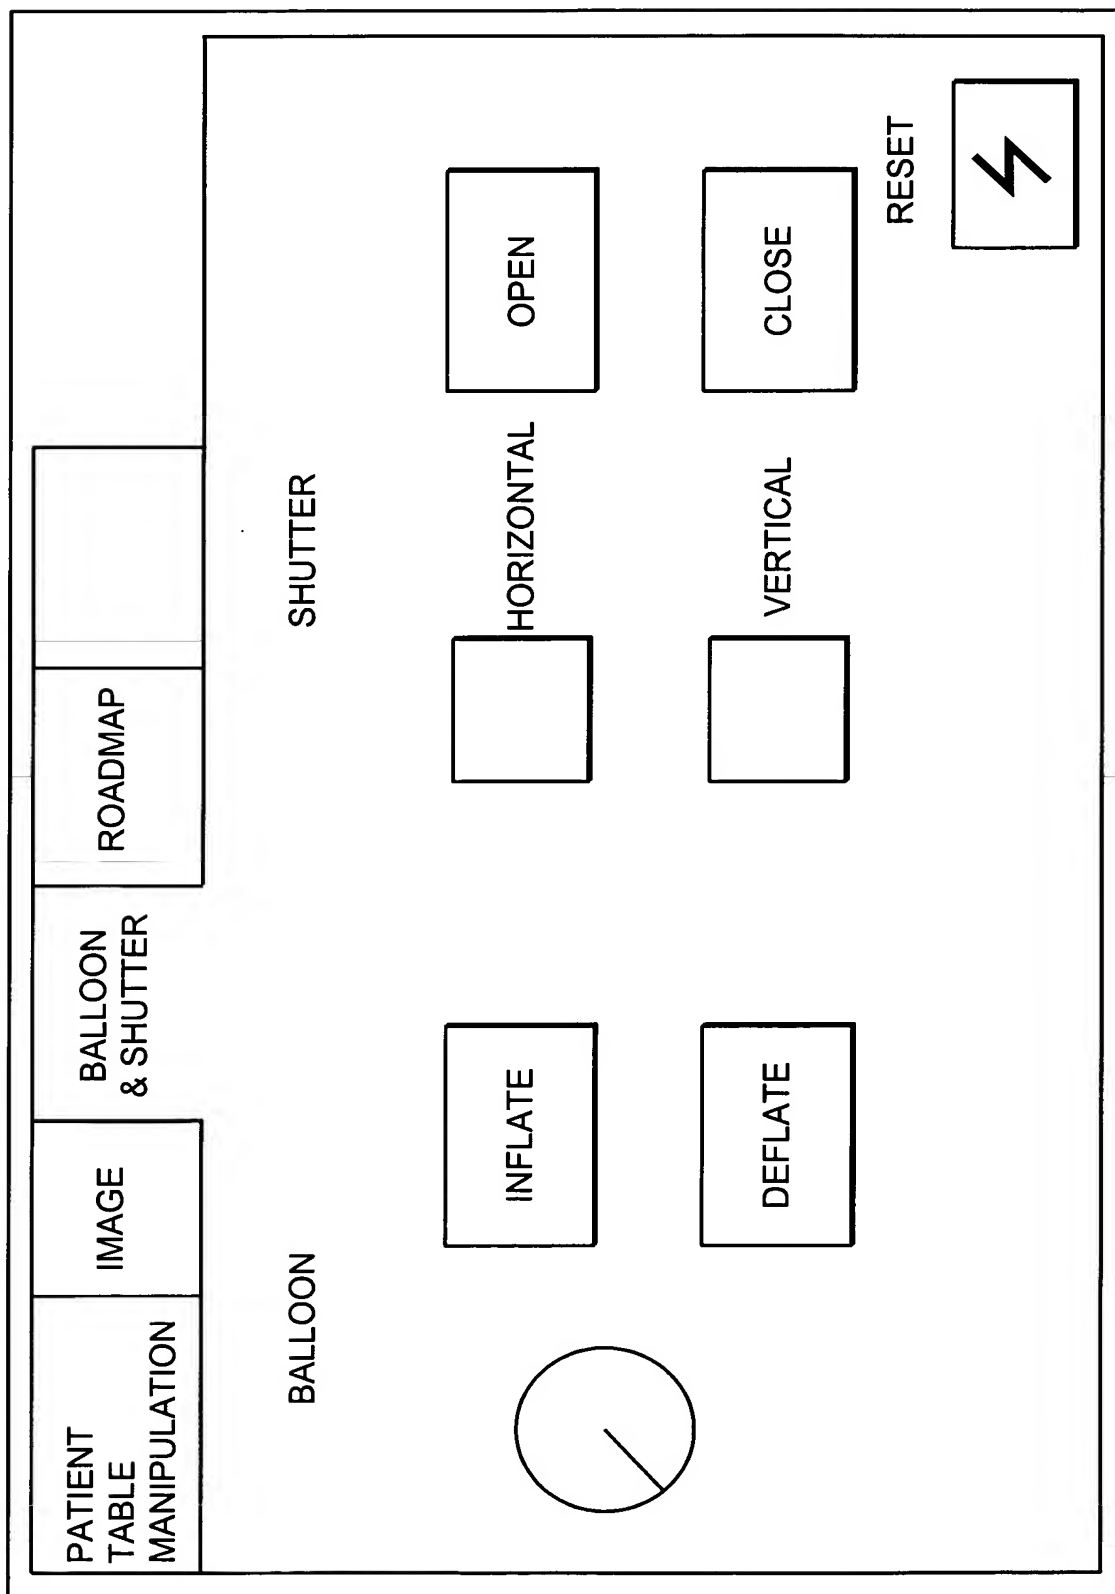


FIG. 10C

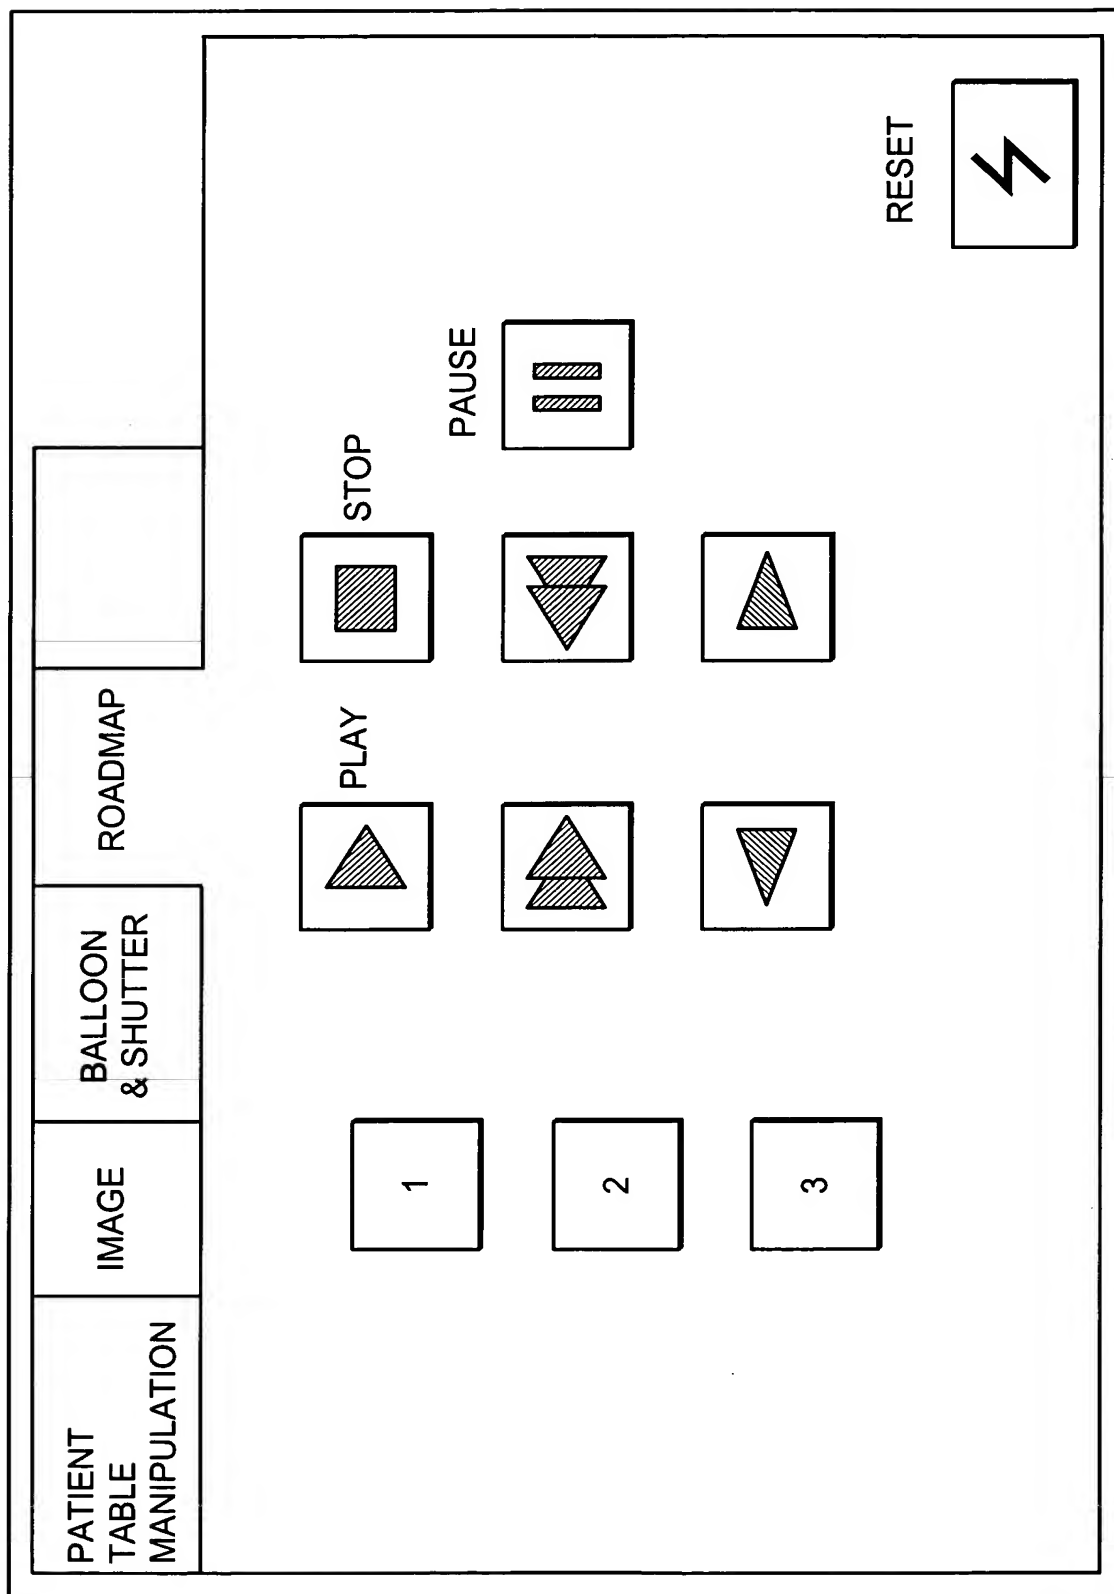


FIG. 10D

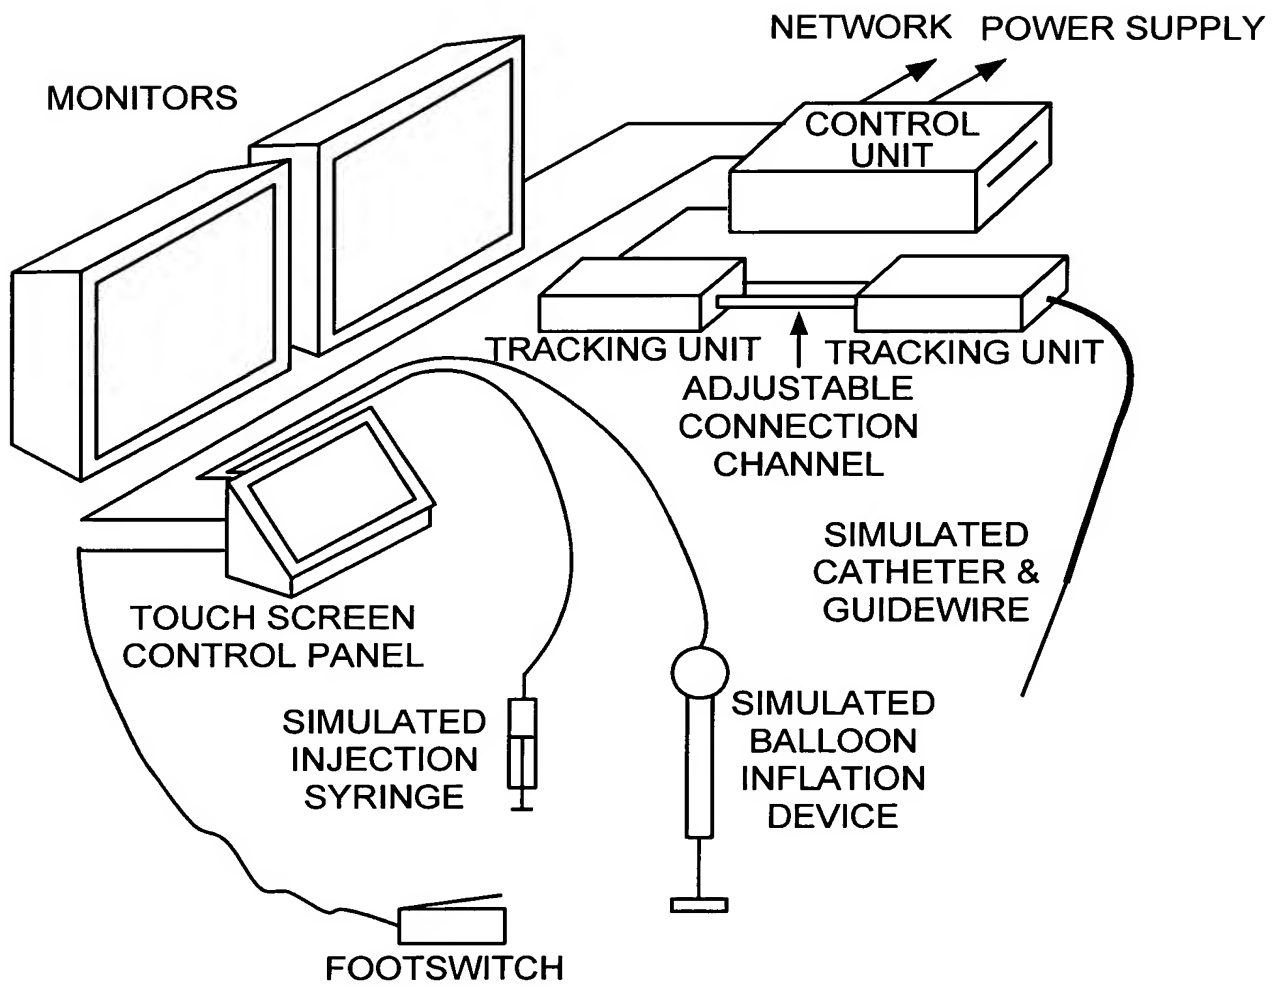


FIG. 11

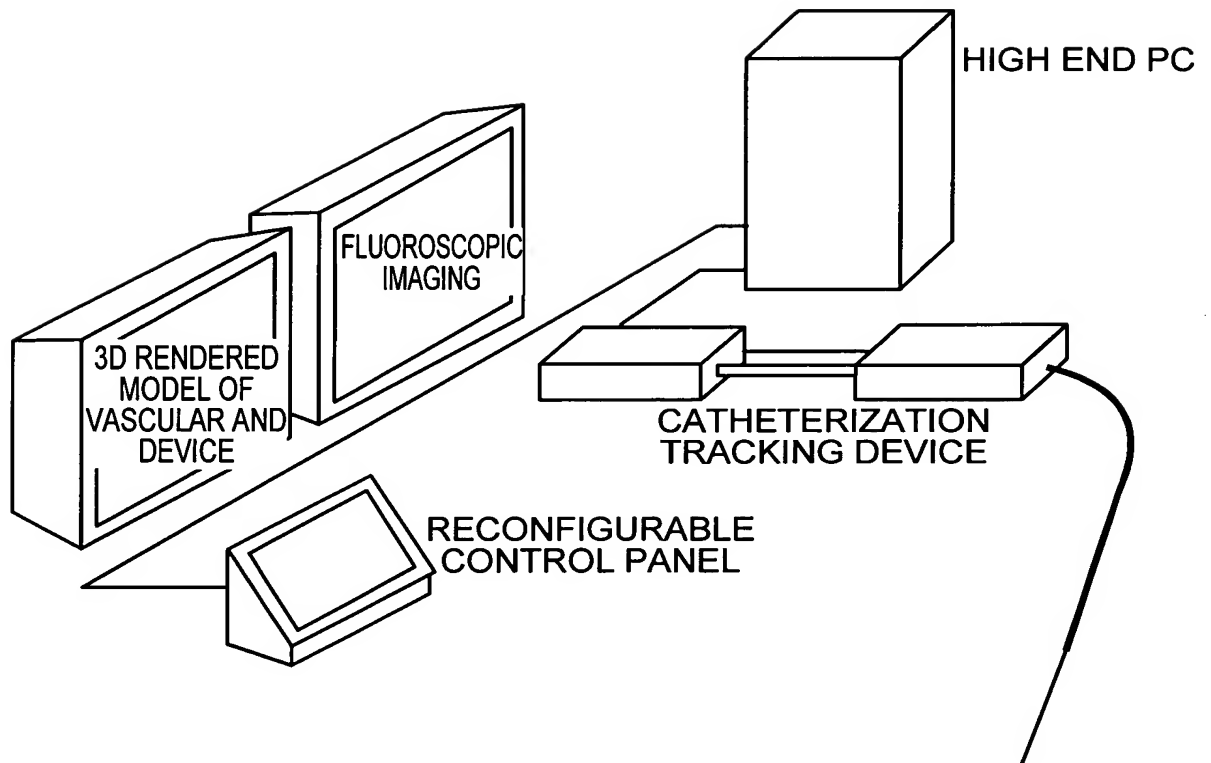


FIG. 12



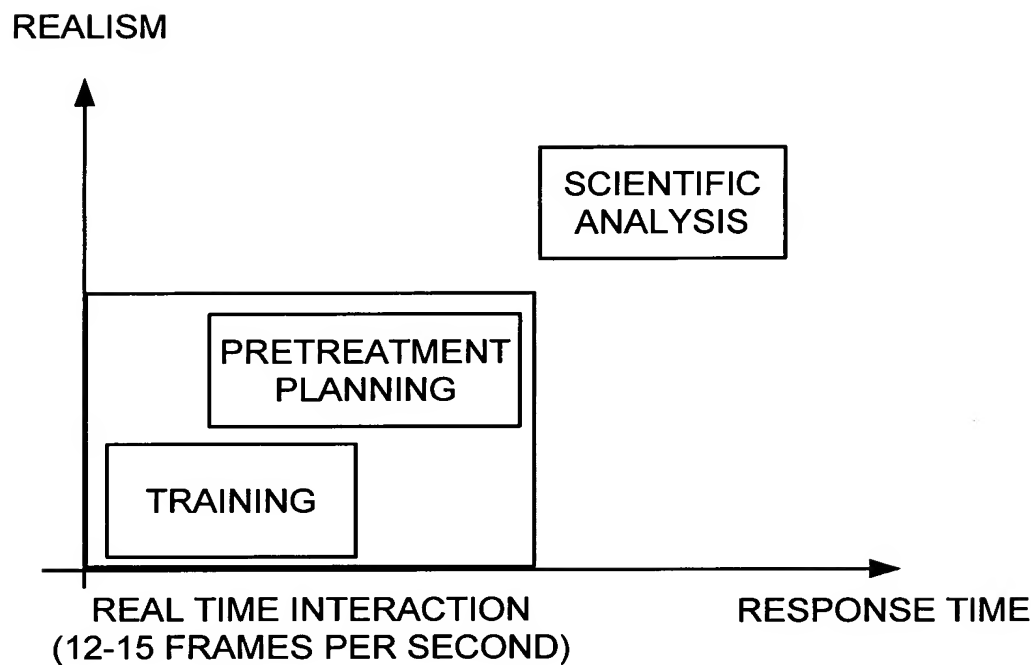


FIG. 14

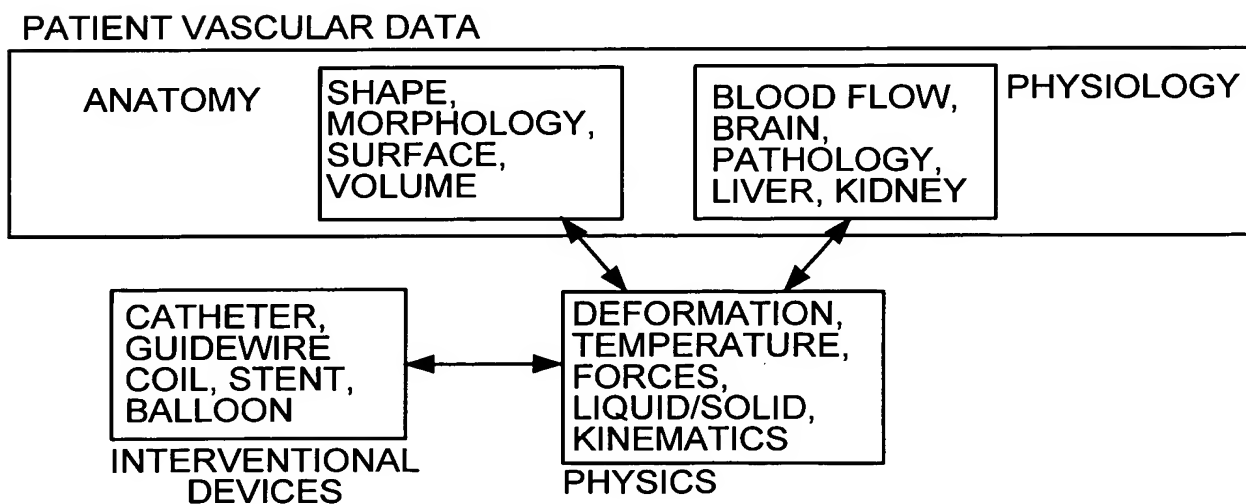


FIG. 15

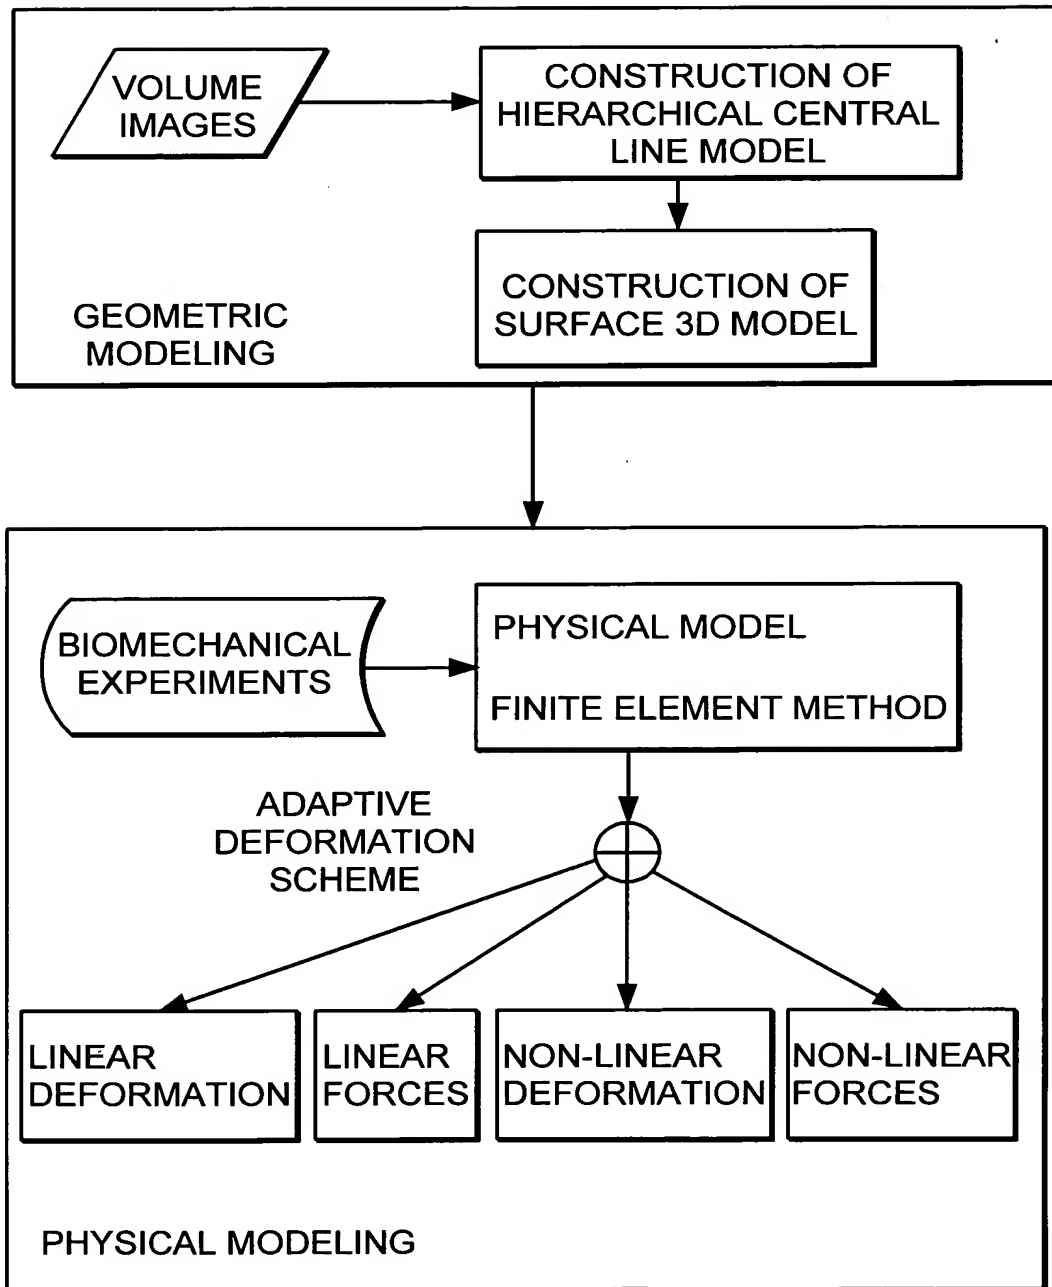


FIG. 16